



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325  
Lębork, dn. 09.10.2015 r.

SPSZOZ/2014/2015

### Uczestnicy postępowania ZP-PN/UE/48/15

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku**  
do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.  
Znak sprawy ZP-PN/UE/48/15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Pytanie nr 1 – dotyczy zad. nr 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 9 zestawu do wkluc centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7.5F – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 2 – dotyczy zad. nr 46

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 1, co możliwi przedstawienie atrakcyjnej oferty.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 3 – dotyczy zad. nr 46

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 4, co możliwi przedstawienie atrakcyjnej oferty.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.


#### Pytanie nr 4 – dotyczy zad. nr 25

Czy Zamawiający może wydzielić z całego zadania poz. 5, 6 oraz 9 i 10, tworząc oddzielny pakiet, lub zezwolić na składanie w tym zadaniu ofert na poszczególne pozycje asortymentowe?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 5, 6 oraz 9 i 10 z zadania nr 25.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wyłączył poz. 5, 6 oraz 9 i 10 z zadania nr 25 i utworzył zadanie nr 25A. Zamawiający informuje, iż zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 5 – dotyczy zad. nr 25**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 basen plastikowy sanitarny z pokrywką, o wym. jak na rys.?

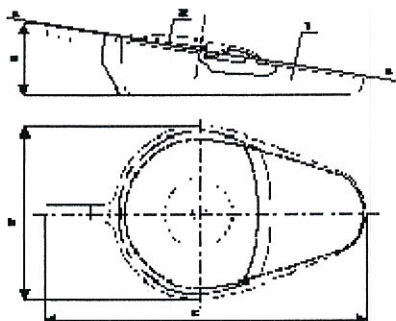


a= 120,5 mm(wysokość), b= 291,5 mm(szerokość), c= 547,5 mm (długość)

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 – dotyczy zad. nr 25**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 basen plastikowy sanitarny z pokrywką, o wym. jak na rys.?

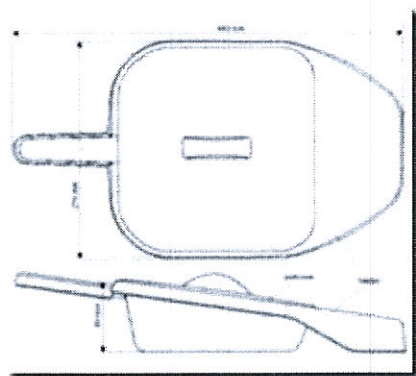

480 mm długość; 270 mm szerokość ; 80 mm wysokość

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania basen plastikowy sanitarny z pokrywką, o w/w wymiarach.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 25A poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 7 – dotyczy zad. nr 40**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 40 poz. 1 elektrody pediatrycznej o średnicy 32mm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8 – dotyczy zad. nr 40**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 40 poz. 3 elektrody do Holtera w rozmiarze 42x56mm.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania elektrody do Holtera w rozmiarze 42x56mm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 40 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane w postępowaniu akcesoria do defibrylatorów Lifepak były akcesoriami oryginalnymi? Zgodnie z art. 90 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (DZ.U.2010 nr 107 poz. 679 z późn.zm.) dostarczane akcesoria powinny być zgodne z wymogami jakie producent urządzenia medycznego określił w instrukcji użytkownika, ze względu na prawidłowe działanie tego urządzenia, bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii oraz bezpieczeństwo użytkownika urządzenia medycznego. Instrukcja użytkownika urządzenia medycznego w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej producenta: [www.physio-control.com](http://www.physio-control.com).

- Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania oryginalne akcesoria do defibrylatorów Lifepak.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję 3: elektroda EDGE System ze złącznikiem QUICK-COMBO i REDIPAK przeznaczone do defibrylatora Lipepak 500, Lifepak 1000 firmy Medtronic z pakietu 41 i utworzyć z niej oddzielny pakiet? Pozwoli to na złożenie oferty producentowi oryginalnych akcesoriów do defibrylatorów Lifepak. Dodatkowo Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy forma „Lipepak” w opisie pozycji jest wynikiem literówki?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 z zadania nr 41.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wyłączył poz. 3 z zadania nr 41 i utworzył zadanie nr 41A. Zamawiający informuje, iż zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 11 – dotyczy zad. nr 43 poz. 2 i 3**

Jaki papier i do jakiego defibrylatora Lifepak ma na myśli Zamawiający w pozycji 3 zadania 43? Pozycja 2 i 3 w opinii Wykonawcy odnoszą się do jednego i tego samego typu papieru, jednakże zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12 – dotyczy zad. nr 43 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości papieru zaoferowanego w pozycji 2 z 50 do 51 rolek? Oryginalny papier 50 mm jest pakowany fabrycznie w niepodzielne opakowania a' 3 rolki.

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zwiększenie ilości papieru zaoferowanego w pozycji 2 z 50 do 51 rolek.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 43 poz. nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 13 – dotyczy zad. nr 43 poz. 3**

Jaką jednostkę miary określoną jako sztuka ma na myśli Zamawiający w pozycji 3 zadania 43 – rolkę czy opakowanie zbiorcze? Jeśli jednostką miary jest rolka, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości zaoferowanego papieru z 25 do 24 rolek? Oryginalny papier 50 mm jest pakowany fabrycznie w niepodzielne opakowania a' 3 rolki.

- Zamawiający informuje, że jako jednostkę miary miał na myśli opakowanie zbiorcze.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 43 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 14 – dotyczy zad. nr 58**

Kaniule do pomiaru kapnometrii do Lifepak 12 są pakowane fabrycznie w opakowania a' 25 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie zamawianej w zadaniu 58 ilości kaniul z 20 do 25, tj. do jednego pełnego opakowania? Dodatkowo Wykonawca prosi o doprecyzowanie, jakiego rodzaju kaniul wymaga Zamawiający: dla pacjentów intubowanych na okres do 24 czy do 72 h?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zwiększenie ilości kaniul w pozycji 1 z 20 do 25 szt., oraz Zamawiający wyjaśnia, że w/w kaniule przeznaczone są dla pacjentów intubowanych na okres do 24 h.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 58 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 15 – dotyczy zad. nr 30**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Zadania nr 30 pozycji 4 – „worki kolostomijne zamknięte fi 20-60 mm (rozmiar 15-70mm) przezroczyste ( pakowane po 30szt )Worek kolostomijny, jednoczęściowy, przylepiec wykonany z materiału zapobiegającemu podrażnieniom skóry i posiadający właściwości gojące, wyposażony w nowoczesny filtr (100% aktywnego węgla )regulujący przepływ gazów ,łatwość szybkiego i precyzyjnego docięcia przylepca do kształtu stomii o pojemności 420ml”, i utworzenia dla pozycji 4 osobnego zadania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16 – dotyczy zad. nr 38 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego zestawu One Day Set do laktatora Medela Lactina bez butelki?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania jednorazowy zestaw One Day Set do laktatora Medela Lactina bez butelki.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 38 poz. nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 17 – dotyczy zad. nr 8**

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z zadania 8 i zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętnicy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18 – dotyczy zad. nr 32 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczki nitrylowe o nieznacznej różnicy w grubości palca tj. mediana 0,10-0,11mm, poziomie szczelności AQL 1,5 o siłach zrywania zgodnie z wymaganiem normy EN 455:2 min. 6N, co w żaden sposób nie wpływa na walory użytkowe rękawic.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19 – dotyczy zad. nr 32 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych; teksturowanych na końcach palców; mankiet równomiernie rolowany; długość rękawicy min. 240 mm; grubość rękawicy na palcu 0,12 mm ± 0,01 mm; AQL 1,0; siła zrywu przed starzeniem mediana min. 8N, rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III; zgodność z normami EN 455 (1-4 ); EN 374, EN 420,przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania; przebadane na min. 7 substancji chemicznych ( nie będących cytostatykami) według normy EN 374-3 z poziomem ochrony klasa 6; przebadane zgodnie z normą EN 374-3, obowiązującą w Unii Europejskiej( norma ASTM D 6978 nie obowiązuje w Europie zatem posiadanie jej jest nieuzasadnione i nie jest żadnym potwierdzeniem parametrów ochronnych zgodnych z prawem Europejskim), na przenikanie min. 15 cytostatyków , rękawice w kolorze niebieskim lub fioletowym; deklaracja do kontaktu z żywnością, rozmiar od XS do XL; pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe; teksturowane na końcach palców; mankiet równomiernie rolowany; długość rękawicy min. 240 mm; grubość rękawicy na palcu 0,12 mm ± 0,01 mm; AQL 1,0; siła zrywu przed starzeniem mediana min. 8N, rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III; zgodność z normami EN 455 (1-4 ); EN 374, EN 420,przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania; przebadane na min. 7 substancji chemicznych ( nie będących cytostatykami) według normy EN 374-3 z poziomem ochrony klasa 6; przebadane zgodnie z normą EN 374-3, obowiązującą w Unii Europejskiej( norma ASTM D 6978 nie obowiązuje w Europie zatem posiadanie jej jest nieuzasadnione i nie jest żadnym potwierdzeniem parametrów ochronnych zgodnych z prawem Europejskim), na przenikanie min. 15 cytostatyków , rękawice w kolorze niebieskim lub fioletowym; deklaracja do kontaktu z żywnością, rozmiar od XS do XL; pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 32 poz. nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 20 – dotyczy zad. nr 32 poz. 2**

Prosimy o wydzielenie z zadania 32 rękawiczek nitylowych znajdujących się w poz.2 oraz rękawic lateksowych z pozycji 4, co przyczyni się do konkurencyjności ofert.

Pragniemy podkreślić iż wymogi postawione przez Zamawiającego w zadaniu 32 może spełnić tylko jeden wykonawca firma Mercator Medical S.A., co jest mocnym ograniczeniem uczciwej konkurencji lub jej brak (na rynku obecnie jest kilku renomowanych dostawców rękawic) a tym samym łamaniem zasad ustawy pzp.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21 – dotyczy zad. nr 32**

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie pojedynczego dozownika uniwersalnego z przeliczeniem ilości ponieważ „koszyczki dwudzielne „ opisane w Uwadze posiada tylko firma Mercator na której zlecenie zostało to wykonane – jednocześnie chcemy nadmienić iż w przyszłości opakowania innych producentów mogą nie pasować do owych koszyczków.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22 – dotyczy zad. nr 50**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do. ww. pakietu w miejsce paskowego mocowania pacjenta czapeczek o obwodach głowy podanych poniżej:

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brazowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23 – dotyczy zad. nr 67**

Prosimy o dopuszczenie do pozycji nr w zadaniu nr 67 –

**Jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant Flow** z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).

**Odcinek wdechowy** jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem. W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

**Odcinek pomiarowy** do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

**Odcinek łączący** nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

**Generator** umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez **przegub obrotowy**, mocowany do czapki za pomocą tasemek.

**Końcówka donosowa** łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24 – dotyczy zad. nr 5 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły o długości 16cm jako równoważnej do wymaganej w SIWZ15cm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25 – dotyczy zad. nr 5 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji nr 5 i utworzenie odrębnego zadania dla igieł do biopsji gruboigłowej typ QuickCore.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26 – dotyczy zad. nr 23**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakich igieł do nakłuć diagnostycznych Zamawiający oczekuje tzn. czy mają to być standardowe igły manualne, czy półautomatyczne, strzelające?

Jeśli mają to być igły półautomatyczne, to bardzo prosimy o sprecyzowanie, czy z funkcją jednej długości wycinka, czy z możliwością pozyskiwania według potrzeb dwóch długości 15 i 22mm.?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27 – dotyczy zad. nr 64 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych wykonanych z poliolefiny ze zintegrowaną pokrywą wyposażoną w dwa porty przyłączeniowe (do pacjenta, oraz do połączenia w tandem). Wkłady posiadają funkcję samozasysania, są wyposażone w pętlę do obsługi przy wyjmowaniu z kanistra przez osoby prawo i leworęczne. Data ważności na każdym podstawowym opakowaniu zbiorczym. Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania wkład workowy wykonany z poliolefiny ze zintegrowaną pokrywą wyposażoną w dwa porty przyłączeniowe (do pacjenta, oraz do połączenia w tandem). Wkłady posiadające funkcję samozasysania, wyposażone w pętlę do obsługi przy wyjmowaniu z kanistra przez osoby prawo i leworęczne. Data ważności na każdym podstawowym opakowaniu zbiorczym. Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 64 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 28 – dotyczy Formularza oferty**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

- Zamawiający informuje, iż uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.

**Pytanie nr 29 – dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1**

Wnosimy o modyfikację zapisu na:

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności (...)

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30 – dotyczy zad. nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkluc centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20 cm bez naklejek identyfikacyjnych? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno - użytkowych oraz jakości.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31 – dotyczy zad. nr 67 poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 32 – dotyczy zad. nr 67 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza układ z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem dł. 0,3 m i generatorem dwudyszowym?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania układ z dodatkowym niepodgrzewanym

odcinkiem dł. 0,3 m i generatorem dwudyszowym.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 67 poz. nr 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 33 – dotyczy zad. nr 67 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga komory z systemem zabezpieczającym przed nadmiernym parowaniem?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 34 – dotyczy zad. nr 67 poz. 5**

Czy komora ma posiadać oznakowanie datą przydatności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 35 – dotyczy zad. nr 53 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane wapno sodowane było niekaustyczne?

- Zamawiający informuje, że wymaga aby oferowane wapno sodowane było niekaustyczne stosowane do aparatury medycznej.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 53 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 36 – dotyczy zad. nr 53 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby wybarwienie, wskazujące na stopień zużycia granulatu oferowanego wapna sodowanego, było trwałe i nieodwracalne?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 37 – dotyczy zad. nr 50 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czapeczek zamiast mocowania paskowego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 38 – dotyczy zad. nr 64 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pojemności wkładów. Czy mają być 1l, 2l czy też obie pojemności?

- Zamawiający informuje, że wymaga wkładów o pojemności 1l i 2l.

**Pytanie nr 39 – dotyczy zad. nr 64 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu?

Prośbę swą motywujemy faktem, iż wkłady w pozycji 2 i 3 są stosowane do zupełnie innego systemu różnych producentów.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 40 – dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 41 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie.
  - 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy;

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto zamówienia.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 42 – dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 2**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

*Zamawiający zaznacza, że podane w formularzu asortymentowo-cenowych ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego w granicach 80% ogólnej wartości umowy.*

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 43 – dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2**

Prosimy o zmianę niniejszego zapisu na następujący:

„strony oświadczają, że ceny jednostkowe netto nie ulegną wzrostowi przez cały okres trwania umowy licząc od daty upływu terminu związania ofertą”.

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 2 wzoru umowy na następującą treść: „strony oświadczają, że ceny jednostkowe netto nie ulegną wzrostowi przez cały okres trwania umowy licząc od daty upływu terminu związania ofertą”.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w § 3 ust. 2 wzoru umowy załącznika nr 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 44 – dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2 pkt. 1)**

Prosimy o dodanie do par. 3 następującego zapisu:

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

- **Zamawiający informuje, że dokonał zmian zapisu § 8 ust. 2 pkt. 1) wzoru umowy na następującą treść: „Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian”.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w § 8 ust. 2 pkt. 1) wzoru umowy załącznika nr 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 45 – dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 4 na:

„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 46 – dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5**

Wnosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie nr 47 – dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

„Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dalszych dostaw, o ile opóźnienie w zapłacie nie przekracza 30 dni”.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 48 – dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2**

Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu na następujący:

„trzykrotna rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 49 – dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

*Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody Zamawiającego (dłużnika) ani też zawierać umów poręczenia bez jego zgody. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.*

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 50 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. 2)**

Prosimy o wykreślenie zapisu: za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 51 – dotyczy zad. nr 34 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu osłon na ramię C o nast. składzie: 1x półrękaw 195x30 cm oraz 2x pokrowce 65x75 cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 52 – dotyczy zad. nr 34 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wym. 33x110 cm z 2 taśmami 10x50 cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 53 – dotyczy zad. nr 34 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłon o wym. 50x110cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 54 – dotyczy zad. nr 46 poz. 5**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 46 pozycje 5 i utworzy z niej odrębny pakiet? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 z zadania nr 46 oraz Zamawiający informuje, że usunął zapis o treści: „firmy Drager” z opisu filtra wydechowego do respiratora Bennet 840.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wyłączył poz. 5 z zadania nr 46 i utworzył zadanie nr 46A. Zamawiający informuje, iż zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 55 – dotyczy zad. nr 4 poz. 1 – 10**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie zaoferować Państwu dobrej jakości asortyment w atrakcyjnej cenie.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 56 – dotyczy zad. nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną której igła kaniuli zaopatrzona jest w automatyczny zatrząsk zabezpieczający przed zakłuciem oraz zachlapaniem. Posiadają dodatkowy otwór boczny w igle umożliwiający szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Kaniule cechują się wysokim standardem wykonania i są produktem bardzo dobrej jakości. Kaniule pakowane są w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie i utratę jałowości, materiał wykonania – papier klasy medycznej, 24G ( 0,7 x 19) przepływ 22ml/min.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 57 – dotyczy zad. nr 8 poz. 2 – 7**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu. Posiada 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, w pozycji nr. 7 (G14) fi 2,2 x 45, przepływ 290 m/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 58 – dotyczy zad. nr 8 poz. 1 – 12, 23, 24, 25**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie zaproponować dobrej jakości asortyment w konkurencyjnej cenie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 59 – dotyczy zad. nr 8 poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dziecięcej do wlewów dożylnych wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, 0,7 x 19 mm o przepływie 13ml/min.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 60 – dotyczy zad. nr 8 poz. 8**

Czy Zamawiający miał na myśli kaniulę nie posiadającą skrzydełek?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 61 – dotyczy zad. nr 8 poz. 10, 11, 12**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu, zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć atrakcyjną ofertę. Pytanie jest zasadne ze względu na duże ilości Zamawiającego asortymentu. Wydzielenie pozycji pozwoli uzyskać większą liczbę ofert oraz niższe ceny produktów.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 62 – dotyczy zad. nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę innego producenta niż kaniule w pozycji 2-7 ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 63 – dotyczy zad. nr 10 poz. 2, 3**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 64 – dotyczy zad. nr 10 poz. 2, 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie z ww. pozycji odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć atrakcyjną ofertę.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 65 – dotyczy zad. nr 11 poz. 5**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej z wydłużoną skalą do 22 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 66 – dotyczy zad. nr 72 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon posiadający zintegrowane osłony na obuwiu (kombinezon jednoczęściowy)?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 67 – dotyczy zad. nr 72 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wyposażony w okulary ochronne lub kaptur ze zintegrowanym wizjerem?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 68 – dotyczy zad. nr 72 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści półmaskę wirusobójczą FFP2? Obecnie nie ma na rynku maski biobójczej FFP3 typu 95 – została ona wycofana z produkcji.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania półmaskę wirusobójczą FFP2.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 72 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 69 – dotyczy zad. nr 72 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie będący wyrobem medycznym, posiadający deklarację zgodności, dokumenty na poszczególne elementy wchodzące w jego skład?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania zestaw nie będący wyrobem medycznym lecz posiadający deklarację zgodności oraz dokumenty na poszczególne elementy wchodzące w jego skład.

**Pytanie nr 70 – dotyczy zad. nr 28 poz. 1, 3, 6, 9 i 11**

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 2 pozycje:

1, 3, 6, 9, 11 co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie od oferentów bardziej atrakcyjnej oferty cenowej?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 1, 3, 6, 9 i 11 z zadania nr 28.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wyłączył poz. 1, 3, 6, 9 i 11 z zadania nr 28 i utworzył zadanie nr 28A. Zamawiający informuje, iż zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 71 – dotyczy zad. nr 28 poz. 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu dla dorosłych i dla dzieci mikrobiologicznie czyste? Pragniemy zaznaczyć, iż inne produkty w tym pakiecie nie są wymagane sterylne.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 72 – dotyczy zad. nr 61 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści obwód rozciągliwy do 180 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub obwód rozciągliwy do 180 cm czysty mikrobiologicznie z zachowaniem pozostałych parametrów?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania obwód rozciągliwy do 180 cm sterylne. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 61 poz. nr 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 73 – dotyczy zad. nr 33 poz. 3**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a to zwiększy konkurencyjność w postępowaniu i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszej oferty?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 74 – dotyczy zad. nr 44 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, chłonności 570% o składzie:

serweta z przylepcem	1		260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta z przylepcem	1		240x150		
pokrowiec na nogę	1		120x37		

kieszon na płyny z kształtką	1		40x30		
taśma medyczna	6		50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m2), warstwa chłonna 85x76cm	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Lub

serweta	1		260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta	1		240x150		
serweta	1		90x75		
serweta	3		250x160		
pokrowiec na nogę	1		120x37		
kieszon na płyny z kształtką	2		40x30		
taśma medyczna	7		50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m2), warstwa chłonna 85x76cm	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 75 – dotyczy zad. nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 73g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/100kPa, o chłonności min. 820% o składzie:

serweta z przylepcem	1		260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta z przylepcem	1		240x150		
pokrowiec na nogę	1		120x37		
kieszon na płyny z kształtką	1		40x30		
taśma medyczna	6		50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m2), warstwa chłonna 85x76cm	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 76 – dotyczy zad. nr 44 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H<sub>2</sub>O, barierowego i chłonnego na całej powierzchni, o chłonności min. 570% o składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1		320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1		75x37		
taśma medyczna	2		50x9		
serweta na stół instrum. (szerokość warstwy chłonnej 66cm)	1		190x150		
serweta na stolik Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m2), warstwa chłonna 85x76cm	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 77 – dotyczy zad. nr 44 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestetycznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirurg., w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1				260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1				90x75
taśma medyczna	1				50x9

kieszon na płyny	1		42x35
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 78 – dotyczy zad. nr 44 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, o chłonności min. 570% o składzie:

serweta z workiem, folią chirurgiczną	1		320x180	PROST.
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1		90x60	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo, warstwa chłonna 85x76cm	1		145x80	
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20	

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 79 – dotyczy zad. nr 44 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kieszon w rozmiarze 40x30cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 80 – dotyczy zad. nr 44 poz. 6**

Czy w miejsce serwety 50x60cm Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 81 – dotyczy zad. nr 44 poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga serwet jałowych?

- Zamawiający wymaga serwet jałowych.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 44 poz. nr 7 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 82 – dotyczy zad. nr 44 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce serwety 75x45 z otworem 7cm i przyklepcem zaferować serwetę z otworem 8cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 83 – dotyczy zad. nr 44 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce serwety 90x75 z otworem 8x6cm i przyklepcem zaferować serwetę z otworem 8cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 84 – dotyczy zad. nr 44 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta pod pośladki w formie kieszeni	1	L2	113x90
serweta (owinięcie)	1	L3	150x90
serweta kompresowa	1	włóknina kompresowa	80x60
serweta kompresowa	6	włóknina kompresowa	25x20
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 85 – dotyczy zad. nr 44 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, o chłonności 570%, barierowego i chłonnego na całej powierzchni w składzie:

serweta z wycięciem i przylepcem	1		240x150	WYCIĘC. U	63x7
serweta z przylepcem	1		240x180		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stół Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m <sup>2</sup> ), warstwa chłonna 85x76cm	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		
taśma medyczna	1		50x9		

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 86 – dotyczy zad. nr 44 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw (zapakowany w torebkę papierowo-foliową) wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozerwania na sucho/mokro 218/130kPa, odporność na przenikanie płynów 182cm H<sub>2</sub>O o składzie:

serweta z przylepcem	1	200x180
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
serweta z przylepcem	1	180x180
serweta na stół Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m <sup>2</sup> ), warstwa chłonna 85x76cm	1	145x80
serweta na stół instrum.	1	190x150

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 87 – dotyczy zad. nr 44 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw (zapakowany w torebkę papierowo-foliową) wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, o chłonności 570% w składzie:

serweta do cesarskiego cięcia L2 z folią chirurgiczną i workiem na płyny z zaworkiem	1	320x180cm
serweta z laminatu L2	1	150x90cm
serweta na stół instrumentalny 190cm x 150cm	1	190x150cm
serweta na stół Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m <sup>2</sup> ), warstwa chłonna 85x76cm	1	145x80cm
fartuch Perfect (wykonany z włókniny SMS 35g/m <sup>2</sup> +wzmocnienie 40g/m <sup>2</sup> ), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 65,9kPa, na mokro 64,8kPa	2	L
fartuch Perfect	1	XL
kompresy z gazy 17N, 8W, RTG	4x10	10x10cm
serwety z gazy 17N 4W nitka RTG	5	45x45cm

Zacisk oraz plastikowa miseczka pakowane osobno, poza zestawem. Zaoferowana cena obejmować będzie zestaw+miseczka+zacisk).

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 88 – dotyczy zad. nr 44 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o chłonności 570% w składzie:

serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum. (włóknina 35g/m <sup>2</sup> , folia PE 47g/m <sup>2</sup> , klej 2g/m <sup>2</sup> ), odporność na rozerwani na sucho/mokro 40kPa, odporność na przenikanie cieczy ≥100cmH <sub>2</sub> O	1	190x150
serweta na stół Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m <sup>2</sup> ), warstwa chłonna 85x76cm	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 89 – dotyczy zad. nr 44 poz. 12**

Czy Zamawiający zestaw wykonany z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>, o chłonności min. 820% w składzie:

serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum. (włóknina 35g/m <sup>2</sup> , folia PE 47g/m <sup>2</sup> , klej 2g/m <sup>2</sup> ), odporność na rozerwani na sucho/mokro 40kPa, odporność na przenikanie cieczy $\geq 100\text{cmH}_2\text{O}$	1	190x150
serweta na stolik Mayo (folia 45mikronów, włóknina 24g/m <sup>2</sup> ), warstwa chłonna 85x76cm	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 90 – dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Zamawiający informuje, że za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 91 – dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że zakaz ten nie obowiązuje w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 92 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. 3)**

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara za odstąpienie od umowy określona w par. 7 ust. 1 ppkt 3) wynosiła 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 93 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 94 – dotyczy zad. nr 40 poz. 1, 2, 3**

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podania ceny za op. – 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 95 – dotyczy zad. nr 40 poz. 1, 2, 3**

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 96 – dotyczy zad. nr 41 poz. 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 30 szt. elektrod (czyli 15 op.=2 szt.) czy 30 op. = 2 szt. (60 szt.), ponieważ elektrody do defibrylacji zawsze są sprzedawane parami.

- Zamawiający informuje, że wymaga łącznie 60 szt. elektrod czyli należy wycenić 30 op. po 2 szt.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 41 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 97 – dotyczy zad. nr 42 poz. 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaferować papier oryginalny czy Zamawiający dopuszcza również papier będący zamiennikiem oryginalnego papieru K65HM?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania papier będący zamiennikiem oryginalnego papieru K65HM o parametrach nie gorszych niż opisany w arkuszu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 98 – dotyczy zad. nr 43 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru przeznaczonego do defibrylatora Lifepak 12 i 15 o szerokości 107 mm.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania papier przeznaczony do defibrylatora Lifepak 12 i 15 o szerokości 107 mm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 43 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 99 – dotyczy zad. nr 43 poz. 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być z nadrukiem czy gładki?

- Zamawiający wymaga aby papier do EKG do defibrylatora Lifepak 20 o szerokości 50 mm posiadał nadruk.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 43 poz. nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 100 – dotyczy zad. nr 63 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dostąpienie od wymogu aby czujnik był kalibrowany cyfrowo. Większość czujników SpO<sub>2</sub> (w tradycyjnej technologii) kalibrowanych jest analogowo. Kalibracja cyfrowa nie jest w nich stosowana ze względu na ograniczenia w budowie i pracę na bazie czujników LED a nie czujników cyfrowych. Wymóg kalibracji analogowej i cyfrowej wskazuje bezpośrednio na producenta i typ wyrobu jaki jest wymagany w postępowaniu przetargowym. Obecnie na rynku znajduje się tylko jeden producent tego typu czujników i tylko jeden typ wyrobu spełniający stawiane przez Zamawiającego wymagania: kalibrowane cyfrowo i analogowo są czujniki SpO<sub>2</sub> Nellcor w technologii OxiMax. Dla aparatów (monitorów/urządzeń) pracujących w tej technologii, wymóg taki ma sens, jednakże w przypadku zwykłych urządzeń pomiarowych pracujących w standardowym (analogowym) systemie wymaganie czujników kalibrowanych w sposób cyfrowy jest nieuzasadnione.

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w/w zakresie.

**Pytanie nr 101 – dotyczy SIWZ rozdz. XI pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu wyliczenia wartości brutto w następujący sposób:

**cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek vat = wartość brutto,**

co jest zgodne z §5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Do takiego sposobu wyliczania wartości brutto przystosowane są programy fakturujące. Sposób wyliczenia wskazany przez Zamawiającego powoduje konieczność określenia ceny jednostkowej brutto w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Jeśli tą zaokrągloną wartość pomnożymy przez zamawianą ilość sztuk, wynik nie będzie zgodny z wartością brutto na fakturze.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 102 – dotyczy Projekt umowy § 8 ust. 2 pkt. 4**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie informuje, że wykorzystanie umowy określa § 1 ust. 2 wzoru umowy.



**Pytanie nr 103 – dotyczy pakiet nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze CH5?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 104 – dotyczy zadania nr 1 poz. 11-13**

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny z prowadnicą wystającą na ok. 7cm w opakowaniu bez drapowania na długości i szerokości spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 105 – dotyczy zadania nr 1 poz. 14 -22**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne sterylizowane tlenkiem etylenu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 106 – dotyczy zadania nr 1 poz. 14-22**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne w opakowaniu folia/folia-papier?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 107 – dotyczy zadania nr 1 poz. 14-15**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne z balonem 3-5ml?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 108 – dotyczy zadania nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dreny z trokarem w rozmiarach 16F/24cm, 20F-32F/37cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 109 – dotyczy zadania nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 110 – dotyczy zadania nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dopępowinowy bez oznaczenia długości i skalowania, z paskiem RTG na długości 5-25cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 111 – dotyczy zadania nr 2 poz. 5-8**

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z PCV pokrytego silikonem o długości 40cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania dreny brzuszne z PCV pokrytego silikonem o długości 40cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 2 poz. nr 5-8 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 112 – dotyczy zadania nr 2 poz. 5-8**

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane w 100% z silikonu o długości 50cm w rozmiarach CH27, CH30, CH33, CH36?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 113 – dotyczy zadania nr 2 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści dreny Redon CH16 o długości 1700mm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania dreny Redon CH16 o długości 1700mm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 2 poz. nr 11 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 114 – dotyczy zadania nr 2 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści dreny Redon CH8 o długości 700mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 115 – dotyczy zadania nr 2 poz. 13**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 116 – dotyczy zadania nr 2 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści dren połączeniowy w rozmiarze CH 30?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 117 – dotyczy zadania nr 2 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane ze 100% silikonu o długości ramion 450mm x 180mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 118 – dotyczy zadania nr 2 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z PCV pokrytego silikonem CH34 o długości 40cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 119 – dotyczy zadania nr 2 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 23?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 120 – dotyczy zadania nr 4 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igły innego producenta niż w poz. 1-9? Powyższy zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 121 – dotyczy zadania nr 4 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z zaciskowym łącznikiem do cewnika epiduralnego spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 122 – dotyczy zadania nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy otrzewnej z drenem o długości 100cm, drenem przedłużającym o długości 40cm oraz igły G16/51mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 123 – dotyczy zadania nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy opłucnej z zestawem trzyigłowym o długości 80mm (14G, 16G, 19G) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 124 – dotyczy zadania nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy opłucnej z zestawem trzyigłowym o długości 80mm (14G, 16G, 19G) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 125 – dotyczy zadania nr 5 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnej
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu

- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe
- biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- sterylne
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 126 – dotyczy zadania nr 5 poz. 7-8**

Czy Zamawiający dopuści worki do moczu w rozmiarze 190x70 mm w opakowaniach a'100 szt.?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 127 – dotyczy zadania nr 12 poz. 1,3**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 128 – dotyczy zadania nr 12 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel 4-100mm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 129 – dotyczy zadania nr 12 poz. 7**

Zamawiający dopuści rurki Guedel 000 dł. 30mm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 130 – dotyczy zadania nr 12 poz. 9**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu opakowanie folia-papier zgrzewana miejscowo?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 131 – dotyczy zadania nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 132 – dotyczy zadania nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 285-302 mm w zależności od rozmiaru?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 133 – dotyczy zadania nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 100 µg/dm<sup>2</sup>?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 134 – dotyczy zadania nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50 µg/g?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 135 – dotyczy zadania nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-300 mm w zależności od rozmiaru?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 136 – dotyczy zadania nr 14 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 455mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 137 – dotyczy zadania nr 14 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50 µg/g?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 138 – dotyczy zadania nr 14 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,32mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 139 – dotyczy zadania nr 14 poz. 3**

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą ASTM F 1671?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 140 – dotyczy zadania nr 14 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy spełniające pozostałe parametry?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 141 – dotyczy zadania nr 14 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy ze specjalnym żelem z aloesu w wewnętrznej warstwie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 142 – dotyczy zadania nr 14 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50 µg/g?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 143 – dotyczy zadania nr 14 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm, o długości 280-297mm w zależności od rozmiaru o sile zrywu przed starzeniem 12N?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 144 – dotyczy zadania nr 14 poz. 5**

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic przebadanych na zawartość alergenów lateksu metodą FitKit?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 145 – dotyczy zadania nr 14 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 100 µg/dm<sup>2</sup>?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 146 – dotyczy zadania nr 14 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 147 – dotyczy zadania nr 14 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,23mm o długości 285-300mm w zależności od rozmiaru?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 148 – dotyczy zadania nr 15 poz. 5**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 149 – dotyczy zadania nr 15 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego zgodnie z opisem:

- Końcówka igły z otworem aspiracyjnym
- Regulowana głębokość wkłucia
- Skala w milimetrach
- Anatomicznie przystosowany uchwyt igły
- Usuwalne ostrze perfekcyjne dopasowane do kaniuli igły

Średnica Gauge	Średnica mm	Długość (5-30 mm)/43mm	Długość (22-47 mm)/60mm	Długość 35-60 mm/73mm
14	2,10	ST14-30	ST14-47	ST14-60
15	1,80	ST15-30	ST15-47	ST15-60
16	1,60	ST16-30	ST16-47	ST16-60
18	1,20	ST18-30	ST18-47	ST18-60

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 150 – dotyczy zadania nr 25 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a'75szt?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania kieliszki do leków w opakowaniach a'75szt. z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 151 – dotyczy zadania nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koperty medyczne szare w rozmiarze 24cm x 30cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 152 – dotyczy zadania nr 27 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści koperty medyczne szare sklejjane bez zakładek?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania koperty medyczne szare sklejjane bez zakładek.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 27 poz. nr 1 i 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 153 – dotyczy zadania nr 28 poz. 2, 5, 7, 8, 10**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 2, 5, 7, 8 i 10 z zadania nr 28.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wyłączył poz. 2, 5, 7, 8 i 10 z zadania nr 28 i utworzył zadanie nr 28A. Zamawiający informuje, iż zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 154 – dotyczy zadania nr 28 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o poj. 6ml spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania maskę tlenową z nebulizatorem o poj. 6 ml spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 28 poz. nr 10 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 155 – dotyczy zadania nr 30 poz. 6,7,8,9,11**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 156 – dotyczy zadania nr 30 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii tylko w kolorze białym?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania okularki do fototerapii tylko w kolorze białym spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 30 poz. nr 11 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 157 – dotyczy zadania nr 34 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG:

\* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

\* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

\* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 158 – dotyczy zadania nr 34 poz. 6**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 159 – dotyczy zadania nr 34 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę rozmiarze 30 cm x 80 cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 160 – dotyczy zadania nr 34 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi o rozmiarze 70 cm x 120 cm z dwiema indywidualnie pakowanymi taśmami?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 161 – dotyczy zadania nr 35 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m<sup>2</sup>. Wykonany z włókniny SSMMS. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion wzmocniony. Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Gramatura fartucha w miejscach wzmocnionych 73 g/m<sup>2</sup>.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesączanie płynów 40,5 cm H<sub>2</sub>O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: XL?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 162 – dotyczy zadania nr 35 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści myjki z celulozy Airlaid i folii o wymiarach 16 cm x 23 cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania myjki z celulozy Airlaid i folii o wymiarach 16 cm x 23 cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 35 poz. nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 163 – dotyczy zadania nr 35 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

- Zamawiający nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 164 – dotyczy zad. nr 35 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania komplet pościeli o składzie: - poszwa : 210 cm x 160 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm, prześcieradło: 210 cm x 150 cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 35 poz. nr 9 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 165 – dotyczy zad. nr 35 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne:

- Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>
- Bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- Spodnie z trokami
- Kolor: niebieski
- Niejałowe
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 166 – dotyczy zad. nr 40 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera w rozmiarze 56mm x 42mm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania elektrody do Holtera w rozmiarze 42x56mm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 40 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 167 – dotyczy zad. nr 42 poz. 1,7**

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy zamienników?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania papier będący oryginałem lub zamiennikiem o parametrach nie gorszych niż opisany w arkuszu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 168 – dotyczy zad. nr 42 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x20 z przeliczeniem na 500 rolek?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania papier w rozmiarze 210x20 z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 42 poz. nr 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 169 – dotyczy zad. nr 57 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści suche szczoteczki w opakowaniach a'40 szt. z przeliczeniem na 4 opakowania?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szczoteczki jałowe z gąbką w opakowaniach a'40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 57 poz. nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 170 – dotyczy zad. nr 70 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści końcówki Yankauer CH23 – 3,00mm/6,00mm (wew./zew.) spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 171 – dotyczy zad. nr 72 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw ochrony o składzie:

- kombinezon - 1 szt. - spełnia wymagania dyrektywy 89/686/EWG maska typu FFP3 - 1 szt. - spełnia wymagania dyrektywy 89/686/EWG
- okulary typu gogle - 1 szt. - spełniają wymagania dyrektywy 93/42/EWG
- rękawice ochronne - 2 pary - spełniają wymagania dyrektywy 89/686/EWG
- pokrowce na buty - 1 para - spełnia wymagania dyrektywy 89/686/EWG
- ubranie jednorazowego użytku włókninowe (bluza, spodnie, pokrowce) - 1 kpl spełniają wymagania dyrektywy 93/42/EWG
- worek na odpady - 1 szt?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania wyżej opisany zestaw.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 72 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 172 – dotyczy zad. nr 46 poz. 1**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**


**Pytanie nr 173 – dotyczy zad. nr 63 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie czujników kalibrowanych analogowo. Wymóg kalibracji cyfrowej oznacza, iż Zamawiający oczekuje czujników oryginalnych, które oferowane są tylko przez jednego producenta, co praktycznie wyklucza pozostałych producentów. W zamian proponujemy czujniki kalibrowane analogowo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ, które są aktualnie wykorzystywane w różnych szpitalach.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania czujniki kalibrowane analogowo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 174 – dotyczy zad. nr 69 poz. 1**

Czy Zamawiający ma na myśli złącze DB9

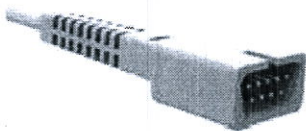

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 175 – dotyczy zad. nr 69 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści czujnik z połączeniem bezpośrednim do monitora?

- **Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 176 – dotyczy zad. nr 69 poz. 3**

Prosimy o podanie modelu kardiomonitora lub nr kat. modułu ?

- **Zamawiający informuje, że nr kat. modułu wynosi 90309.**

**Pytanie nr 177 – dotyczy zad. nr 80 poz. 2,3**

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 178 – dotyczy zad. nr 81 poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy elektrody mają być z kabelkiem z wtykiem DIN czy z zatraskiem?

- **Zamawiający informuje, że wymaga aby elektrody posiadały zatrask.**



- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 81 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 179 – dotyczy zad. nr 81 poz. 1**

Czy Zamawiający ma na myśli 1000 szt. elektrod w kompletach po 3 szt.( kabelek) czy w kompletach po 50 szt. (zatrask)?

- Zamawiający informuje, że wymaga 100 szt. elektrod z zatraskiem oraz dopuszcza możliwość zaoferowania w kompletach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 81 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 180 – dotyczy pakiet nr 83 poz. 3**

Czy elektrody mają być z kabelkiem z wtykiem DIN czy z zatraskiem?

- Zamawiający informuje, że wymaga aby elektrody posiadały zatrask.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 83 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 181 – dotyczy pakiet nr 83 poz. 3**

Czy Zamawiający ma na myśli o 55 sztuk czy o 55 kompletów (kabelek po 3 szt. lub zatrask po 50 szt) elektrod?

- Zamawiający informuje, że wymaga 50 szt. elektrod z zatraskiem.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 83 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 182 – dotyczy Zad. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 9 zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, trzyświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylne, nie zawierający lateksu, składający się z:

- Cewnika o długości 20cm i średnicy 7 F. Średnica każdego światła cewnika 16/18/18G. Na cewniku są znaczniki głębokości (podziałka centymetrowa co 1cm) oraz informacja o rozmiarze (długość, średnica). Cewnik jest widoczny w promieniach Rtg składa się z trzech przezroczystych drenów z zaciskami na których jest informacja o objętości;
- Prowadnicy z elastyczną końcówką J o długości 60cm i średnicy 0,35 cali;
- Strzykawkę 6ml i igły w rozmiarze 18 Ga;
- Rozszerzacz;
- Pojemnika na zużyte igły.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 183 – dotyczy Zad. nr 18**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 18 pozycji 1 do osobnego zadania celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 184 – dotyczy pakiet nr 35 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>. Przód i rękawy fartucha wzmocnione nieprzemakalnym laminatem dwuwarstwowym (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze: przód - 42 g/m<sup>2</sup>; rękawy 40,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym: przód- 1200 mm H<sub>2</sub>O, rękawy- 1800 mm H<sub>2</sub>O; w obszarze niekrytycznym 230 mm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w strefie niekrytycznej 231 kPa, w strefie krytycznej przód: 275 kPa, na rękawach 310 kPa. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety

o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej z 2 ręcznikami wysoko chłonnymi o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm odpowiednio: M, 130 cm odpowiednio: L, 150 cm odpowiednio XL, 170 cm odpowiednio: XXL oraz 150 L, odpowiednio: XL- L dla operatorów o zwiększonych obwodach.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania fartuch chirurgiczny o wyżej opisanych parametrach.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 35 poz. nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 185 – dotyczy pakiet nr 35 poz. 7**

Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole. Pakowany w kartonik, kolor aqua.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania czepek chirurgiczny o wyżej opisanych parametrach.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 35 poz. nr 7 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 186 – dotyczy pakiet nr 35 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania w rozmiarze 16 x 23 cm. Wykonanej z materiału który jest szczególnie miękki a zatem idealnie nadają się do mycia pacjenta. Materiał jest nadmuchany powietrzem dla dodatkowej miękkości oraz chłonności i posiada większą wytrzymałość na mokro w porównaniu do tradycyjnego papieru. Materiał: Napowietrzona włóknina 70 g/m<sup>2</sup>, wiskoza:35 g/m<sup>2</sup>

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania w/w myjki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 35 poz. nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 187 – dotyczy pakiet nr 35 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania fartucha wizytacyjnego w rozmiarze uniwersalnym . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania fartuch wizytacyjny w rozmiarze uniwersalnym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 35 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 188 – dotyczy pakiet nr 35 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompletu wykonanego z włókniny bawełnopodobnej w 100% polipropylenowej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>? Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca przystosowana do użytkowania przez personel bloku operacyjnego. Bluza o kroju reglanowym, posiada krótki rękaw, wycięcie wokół szyi w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie- dwie na dole bluzy oraz jedną, dwudzielną na piersi, a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, wyposażone w dwie kieszenie, posiadające nogawki proste oraz metkę z rozmiarem. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiary XS-XXL.  
Produkt spełnia wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych.

Paroprzepuszczalność: min. 7382 g/m<sup>2</sup>/24h

Wytrzymałość na rozrywanie na sucho: 50 N

Pylenie: 3,2 log<sub>10</sub>

Czystość pod względem cząstek stałych: <3,4 IPM

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania komplet o wyżej opisanych parametrach.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 35 poz. nr 12 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 189 – dotyczy pakiet nr 35 poz. 12**

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowy komplet chirurgiczny był zgodny z normą EN PN 13 795 .

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 190 – dotyczy pakiet nr 2 poz. 5-8**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania drenów do jamy otrzewnej wykonanych z silikonowanego tworzywa o dł. 30 cm . pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 191 – dotyczy pakiet nr 2 poz. 19**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestawu do odsysania pola operacyjnego złożony z końcówki typu OP-Flex Yankauer 24-25CH oraz drenu łączącego o dł. 300-350 cm, z końcówką dopasowaną do każdego typu ssaka przez docięcie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 192 – dotyczy zadania nr 8 poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zaoferowania próbki do pozycji 20 w pakiecie 8 w momencie składania ofert. Prosimy o uwzględnienie możliwości oceny poprawnie zaoferowanego produktu na podstawie wymaganych również dokumentów dołączonych wraz z składaną ofertą czyli szczegółowego opisu oferowanych wyrobów lub katalogu lub folderu potwierdzającego , że zaoferowany wyrób jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości i braku możliwości oceny poprawności zaoferowanego produktu przez Zamawiającego na podstawie dokumentów obowiązkiem wykonawców będzie dostarczenie próbki.

- Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zaoferowania próbki do pozycji 20 w zadaniu 8 w momencie składania ofert.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął wymaganą ilość próbek w załączniku nr 5 zadanie nr 8 poz. nr 20 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 193 – dotyczy zad. nr 55 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopowych o wymiarach: długość szczotki 200cm, max. długość kanału endoskopu 160 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, w miejsce szczotki o długości 160 cm i średnicy 2.7-4.6, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopowych o wymiarach: długość szczotki 200cm, max. długość kanału endoskopu 160 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 55 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 194 – dotyczy zad. nr 55 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopowych o wymiarach: długość szczotki 260cm, max. długość kanału endoskopu 240 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, w miejsce szczotki o długości 260 cm i średnicy 2.7-4.6, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopowych o wymiarach: długość szczotki 260cm, max. długość kanału endoskopu 240 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 55 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 195 – dotyczy zad. nr 12 poz. 10-12**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania pozycji 10,11 oraz 12 i utworzenie oddzielnego pakietu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 196 – dotyczy zad. nr 61 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maski twarzowej wielorazowego użytku z otwartym kołnierzem, wykonanej z silikonu, bez kolorowych oznaczeń.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania maskę twarzową wielorazowego użytku z otwartym kołnierzem, wykonaną z silikonu, bez kolorowych oznaczeń.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 61 poz. nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 197 – dotyczy zad. nr 63 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu kalibracji cyfrowej i analogowej.

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów w w/w zakresie.

**Pytanie nr 198 – dotyczy zad. nr 81 poz. 1**

Prosimy o podanie rozmiaru elektrod i doprecyzowanie czy elektrody mają być z odprowadzeniami czy bez odprowadzeń. Ewentualnie prosimy o podanie numeru katalogowego elektrod obecnie używanych w Państwa placówce.

- Zamawiający informuje, że wymaga elektrod z zatraskiem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 81 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 199 – dotyczy zad. nr 81 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych po 300 sztuk.

- Zamawiający informuje, że wymaga 100 szt. elektrod z zatraskiem oraz dopuszcza możliwość zaferowania w kompletach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 81 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 200 – dotyczy zad. nr 81 poz. 3**

Prosimy o określenie jakiego dokładnie rozmiaru oczekuje Zamawiający:

Rozmiar	Opis
Obwód: 3,1-5,7 cm; szerokość: 2,5 cm;	Mankiet dla niemowląt; rozmiar nr 1
Obwód: 4,3-8 cm; szerokość: 3,2 cm;	Mankiet dla niemowląt; rozmiar nr 2
Obwód: 5,8-10,9 cm; szerokość: 4,2 cm;	Mankiet dla niemowląt; rozmiar nr 3
Obwód: 7,1 – 13,1 cm; szerokość: 5,1 cm;	Mankiet dla niemowląt; rozmiar nr 4
Obwód: 10,0 – 15,0 cm; szerokość: 6,2 cm;	Mankiet dla niemowląt; rozmiar nr 5

- Zamawiający informuje, że wymaga mankietów dla niemowląt w rozmiarach nr 1, 2 i 3.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 81 poz. nr 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 201 – dotyczy zad. nr 81 poz. 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w zadaniu 81 poz. 2 z uwagi na ich wysoki koszt.

- Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zaferowania próbki do pozycji 2 w zadaniu 81 w momencie składania ofert.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął wymaganą ilość próbek w załączniku nr 5 zadanie nr 81 poz. nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 202 – dotyczy zad. nr 32 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic sekcyjnych w rozmiarach:

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania rękawice sekcyjne w rozmiarach: 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 do wyboru. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 32 poz.

**Pytanie nr 203 – dotyczy zad. nr 4 poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępych igieł dedykowanych do bezpiecznego pobierania leków i roztworów z fiolek o specjalnej konstrukcji z otworem centralnym 1,2 x 40 mm (18G)

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 204 – dotyczy zad. nr 4 poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania igły z ostrzem ściętym pod kątem 45° z nasadką dopasowaną do strzykawk Luer i Luer-lock w rozmiarze 18G 1,2 x 40 mm i 1,2 18G x 25 mm

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 205 – dotyczy zad. nr 4 poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igła do pobierania leków z tępym ostrzem ma posiadać unikalne ostrze ścięte pod kątem 45 stopni co pozwala uniknąć ubytku materiału korka i zapobiegać zakłuciu igłą?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 206 – dotyczy zad. nr 4 poz. 1-9**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do iniekcji mają posiadać cienkie ścianki możliwość zastosowania cienkościennej igły o większym świetle pozwala uzyskać wyższe wartości przepływu podczas iniekcji i pobierania.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 207 – dotyczy zad. nr 8 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bez pasków RTG widocznej w USG posiadającej przepływ 13 ml/min.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 208 – dotyczy zad. nr 8 poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadającej dodatkowo, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi oraz zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażeniem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika w rozmiarach następujących:

Rozmiar - 0,9mm - 22G( niebieski ) dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min

Rozmiar - 1,1mm - 20G( różowy ) dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min

Rozmiar - 1,3mm - 18G( zielony ) dł. 32-45 mm , przepływ 103 ml/min

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 209 – dotyczy zad. nr 11 poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie , czy oczekuje zamkniętego systemu dostępu naczyniowego nie mechanicznego, przezroczystego– w pełni przeziernego bezigłowego Luer i Luer lok z jednoelementową, przezierną, silikonową podzielną membraną z zewnątrz osadzoną na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, z kołnierzem wywiniętym zewnątrz bez mechanicznych części wewnętrznych ,z prostym, w pełni widocznym torem przepływu o min. przepływie 525ml/min (+- 25 m). zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3.?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 210 – dotyczy zad. nr 11 poz. 14**

Czy Zamawiający oczekuje zamknięty system dostępu naczyniowego Qsyte wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej , wynoszącej maksymalnie 0,10 m, gdzie czas podłączenia u pacjenta wynosi do 7 dni lub 100 aktywacji.?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 211 – dotyczy zad. nr 11 poz. 14**

Czy Zamawiający oczekuje zamkniętego systemu dostępu naczyniowego Qsyte dostosowanego do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi, zgodnie z międzynarodowymi standardami o skuteczności obniżenia ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych oferowanego produktu potwierdzonego badaniami klinicznymi?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 212 – dotyczy zad. nr 11 poz. 1-5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych sterylnych z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem, ze skalą na cylindrze odpowiadającym skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 213 – dotyczy zad. nr 11 poz. 1-5**

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie w celu nie zawyżania cen pakietu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 214 – dotyczy zad. nr 11 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. a 80 sztuk.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 215 – dotyczy zad. nr 11 poz. 7 i 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 216 – dotyczy zad. nr 11 poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z zamontowaną igłą 0,45 x 10 mm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 217 – dotyczy zad. nr 14 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających rolowany brzeg o długości 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o grubości na palcu 0,21 mm, pakowane w opakowania papierowe wewnątrznie podfoliowane.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 218 – dotyczy zad. nr 14 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL < 1, składanych w połowie o grubości na palcu 0,22 mm

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 219 – dotyczy zad. nr 14 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o grubości na palcu 0,195-0,22 mm

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 220 – dotyczy zad. nr 14 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej (50%/50%), całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkownika naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie, posiadających AQL < 1, o grubości na palcu 0,25 mm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 221 – dotyczy zad. nr 14 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,18 mm o AQL 1,5, zawartość protein <50 ug/g rękawicy o sile zrywania przed starzeniem 12 N

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 222 – dotyczy zad. nr 14 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,32 mm, dodatkowo składanych w połowie, o poziomie protein <50 ug/g rękawicy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 223 – dotyczy zad. nr 14 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek chirurgicznych do zabiegów o podwyższonym ryzyku, sterylne, lateksowe o obniżonej zawartości protein < 15 µg/g bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, o długości mankietu dostosowanej do długości rękawicy, pakowanej osobno po 1 parze w komplecie, co umożliwi indywidualne dopasowanie rozmiaru, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. (Rękawica wewnętrzna w kolorze zielonym), rękawice o długości 270-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 224 – dotyczy zad. nr 14 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających rolowany brzeg o długości 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o grubości na palcu 0,21 mm, pakowane w opakowania papierowe wewnętrznie podfoliowane.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 225 – dotyczy zad. nr 14 poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze brązowym, o grubości na palcu 0,23 mm, siła zrywania przed starzeniem 13 N

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 226 – dotyczy zad. nr 14 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic dodatkowo składanych w połowie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 227 – dotyczy zad. nr 32 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic stosowanych do podwyższonego ryzyka w kolorze niebieskim, o następujących grubościach: Palec 0,09; Dłoń 0,08, pakowane po 100 sztuk, rozmiar XL pakowany po 90 sztuk.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 228 – dotyczy zad. nr 32 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu Palec - 0,10 ±0,01 o poziomie AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem 6 N, pakowane po 100 sztuk (rozmiar XL po 90 sztuk) z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 229 – dotyczy zad. nr 32 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,32 mm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 230 – dotyczy zad. nr 32 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein  $\leq 50 \mu\text{g/g}$  rękawicy.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 231 – dotyczy zad. nr 32 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o długości 240 mm w kolorze niebieskim o grubości na palcu min. 0,1 mm.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 232 – dotyczy zad. nr 32 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,09 mm pakowane w opakowania max 100 sztuk w kolorze niebieskim.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 233 – dotyczy zad. nr 32 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o długości 240 mm w kolorze niebieskim o grubości na palcu min. 0,1 mm  $\pm 0,01$  pakowane w opakowania max 100 sztuk w kolorze niebieskim.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 234 – dotyczy zad. nr 73 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednorazowych o wysokości strzyżenia nieznacznie różniącej się od opisu przedmiotu zamówienia tj. co najmniej 31,5mm, w pozostałym zakresie zgodne z wymogami SIWZ.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ostrze jednorazowe o szerokości strzyżenia co najmniej 31,5mm, w pozostałym zakresie zgodne z wymogami SIWZ.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 73 poz. nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 235 – dotyczy zad. nr 36 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śliniaków zabiegowych będących wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent śliniaków zakwalifikował je jako wyrób higieniczny i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie są wyrobem medycznym.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania śliniaki zabiegowych będących wyrobem higienicznym.**

**Zamawiający informuje, że w związku z wniesionymi pytaniami przedłuża termin składania ofert do 02.11.2015r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 02.11.2015r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.**

1. Przystępując do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 850,00 zł	Zadanie nr 19 – 15,00 zł	Zadanie nr 35 – 2800,00 zł
Zadanie nr 2 – 1600,00 zł	Zadanie nr 20 – 8,00 zł	Zadanie nr 36 – 30,00 zł
Zadanie nr 3 – 9,00 zł	Zadanie nr 21 – 90,00 zł	Zadanie nr 37 – 100,00 zł
Zadanie nr 4 – 700,00 zł	Zadanie nr 22 – 40,00 zł	Zadanie nr 38 – 30,00 zł
Zadanie nr 5 – 1200,00 zł	Zadanie nr 23 – 70,00 zł	Zadanie nr 39 – 50,00 zł
Zadanie nr 6 – 100,00 zł	Zadanie nr 24 – 650,00 zł	Zadanie nr 40 – 500,00 zł
Zadanie nr 7 – 1900,00 zł	Zadanie nr 25 – 800,00 zł	Zadanie nr 41 – 200,00 zł
Zadanie nr 8 – 5600,00 zł	Zadanie nr 25A – 40,00 zł	Zadanie nr 41A – 40,00 zł
Zadanie nr 9 – 600,00 zł	Zadanie nr 26 – 20,00 zł	Zadanie nr 42 – 600,00 zł
Zadanie nr 10 – 600,00 zł	Zadanie nr 27 – 600,00 zł	Zadanie nr 43 – 9,00 zł
Zadanie nr 11 – 2000,00 zł	Zadanie nr 28 – 500,00 zł	Zadanie nr 44 – 7000,00 zł
Zadanie nr 12 – 750,00 zł	Zadanie nr 28A – 300,00 zł	Zadanie nr 45 – 800,00 zł
Zadanie nr 13 – 180,00 zł	Zadanie nr 29 – 30,00 zł	Zadanie nr 46 – 700,00 zł
Zadanie nr 14 – 2800,00 zł	Zadanie nr 30 – 1800,00 zł	Zadanie nr 46A – 90,00 zł
Zadanie nr 15 – 190,00 zł	Zadanie nr 31 – 100,00 zł	Zadanie nr 47 – 9,00 zł
Zadanie nr 16 – 20,00 zł	Zadanie nr 32 – 11000,00 zł	Zadanie nr 48 – 400,00 zł
Zadanie nr 17 – 780,00 zł	Zadanie nr 33 – 1900,00 zł	Zadanie nr 49 – 80,00 zł
Zadanie nr 18 – 100,00 zł	Zadanie nr 34 – 750,00 zł	Zadanie nr 50 – 90,00 zł



Zadanie nr 51 – 10,00 zł  
Zadanie nr 52 – 60,00 zł  
Zadanie nr 53 – 40,00 zł  
Zadanie nr 54 – 30,00 zł  
Zadanie nr 55 – 600,00 zł  
Zadanie nr 56 – 10,00 zł  
Zadanie nr 57 – 20,00 zł  
Zadanie nr 58 – 30,00 zł  
Zadanie nr 59 – 100,00 zł  
Zadanie nr 60 – 2400,00 zł  
Zadanie nr 61 – 900,00 zł  
Zadanie nr 62 – 60,00 zł  
Zadanie nr 63 – 140,00 zł  
Zadanie nr 64 – 400,00 zł

Zadanie nr 65 – 180,00 zł  
Zadanie nr 66 – 60,00 zł  
Zadanie nr 67 – 600,00 zł  
Zadanie nr 68 – 80,00 zł  
Zadanie nr 69 – 300,00 zł  
Zadanie nr 70 – 700,00 zł  
Zadanie nr 71 – 200,00 zł  
Zadanie nr 72 – 100,00 zł  
Zadanie nr 73 – 700,00 zł  
Zadanie nr 74 – 2,00 zł  
Zadanie nr 75 – 130,00 zł  
Zadanie nr 76 – 250,00 zł  
Zadanie nr 77 – 50,00 zł  
Zadanie nr 78 – 2200,00 zł

Zadanie nr 79 – 7,00 zł  
Zadanie nr 80 – 80,00 zł  
Zadanie nr 81 – 300,00 zł  
Zadanie nr 82 – 60,00 zł  
Zadanie nr 83 – 130,00 zł  
Zadanie nr 84 – 400,00 zł  
Zadanie nr 85 – 80,00 zł  
Zadanie nr 86 – 40,00 zł  
Zadanie nr 87 – 1000,00 zł  
Zadanie nr 88 – 20,00 zł  
Zadanie nr 89 – 15,00 zł  
Zadanie nr 90 – 40,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
  - c) gwarancjach bankowych
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **34 1240 3800 1111 0010 6434 1782 z dopiskiem „SPS ZOZ w Łęborku – wadium, ZP-PN/UE/48/15” do dnia 02.11.2015 r. do godziny 12:00.** Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy wnieść w oryginale do Zamawiającego **do dnia 02.11.2015 r. do godz. 12:00** składając dokumenty w Sekretariacie w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „**SPS ZOZ w Łęborku – wadium, ZP-PN/UE/48/15** - nie otwierać przed **02.11.2015 r. godz. 12:30**”. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.
5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 6 i 7 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 6 i 7 poniżej.
6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
  - 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Zamawiający zwróci wadium dla wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku  
*Krzysztof Rebkowicz*